



下附设备图片：


1、激光检测仪 PRK



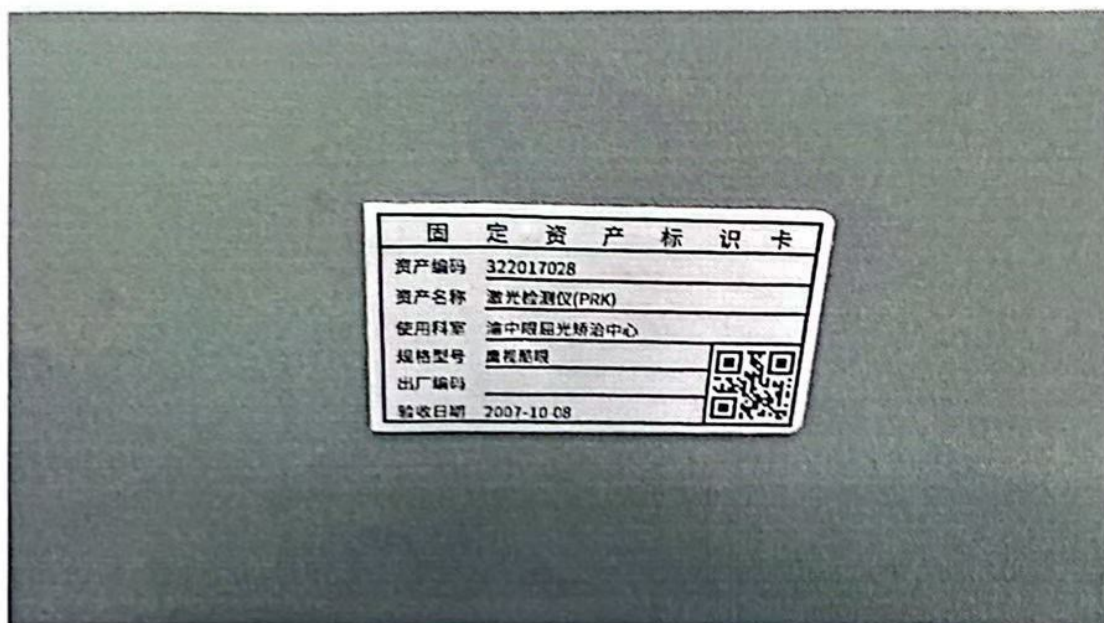

2、核磁共振

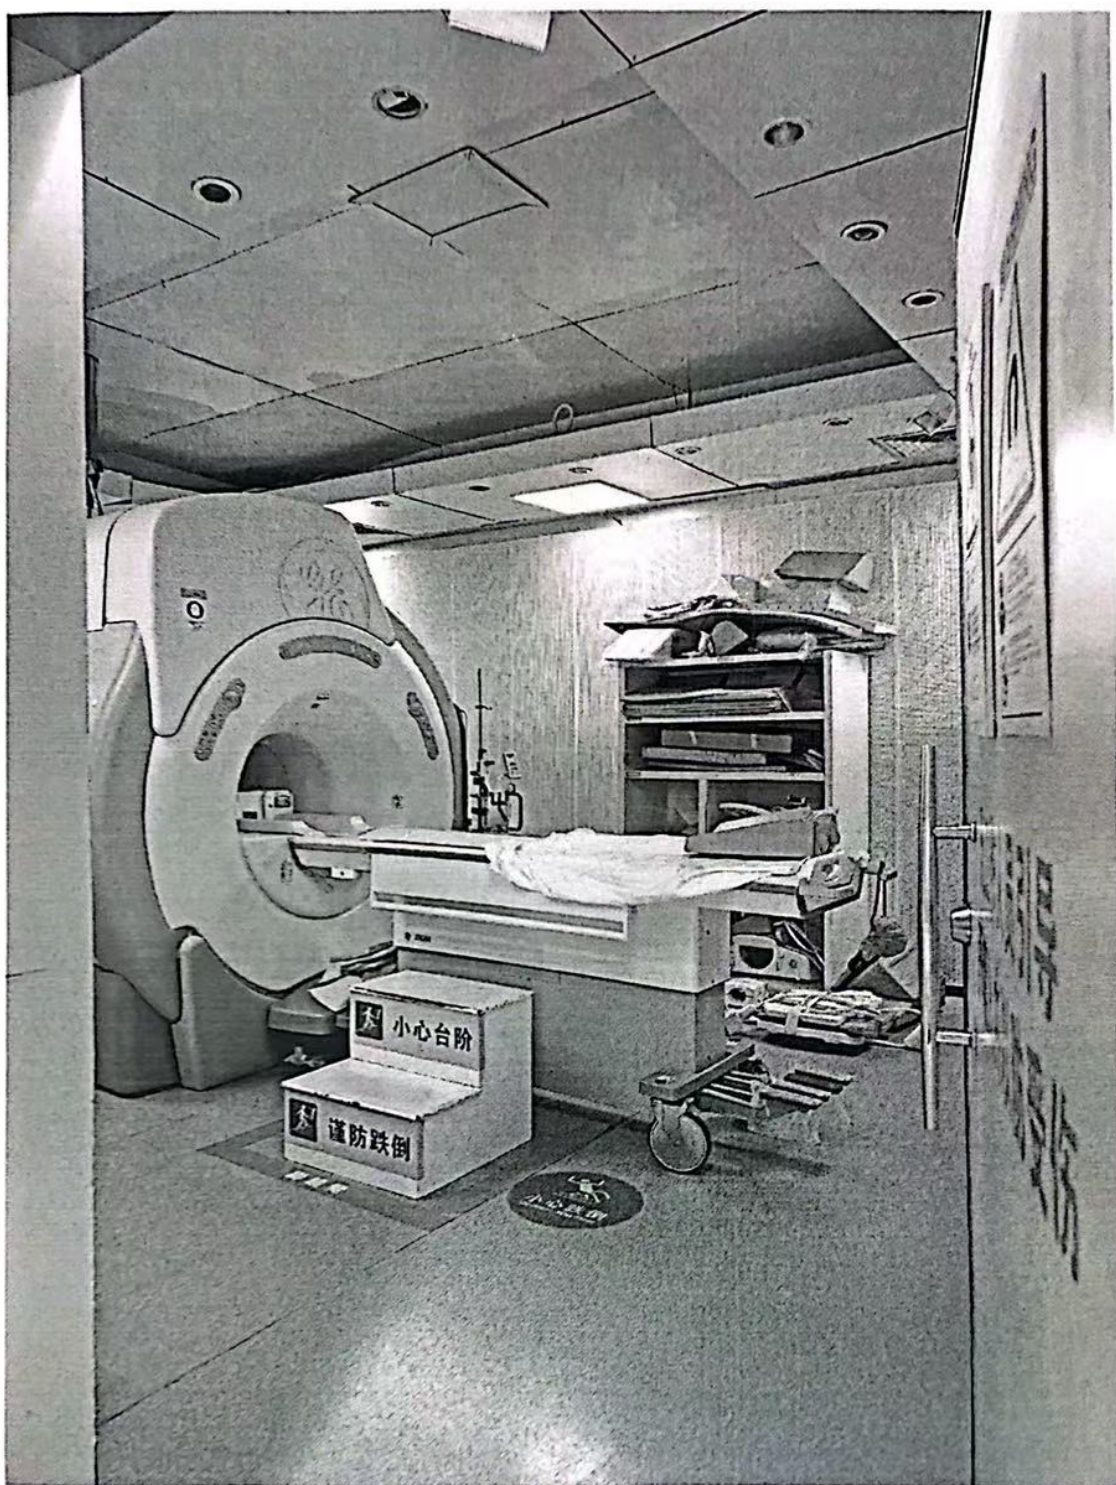

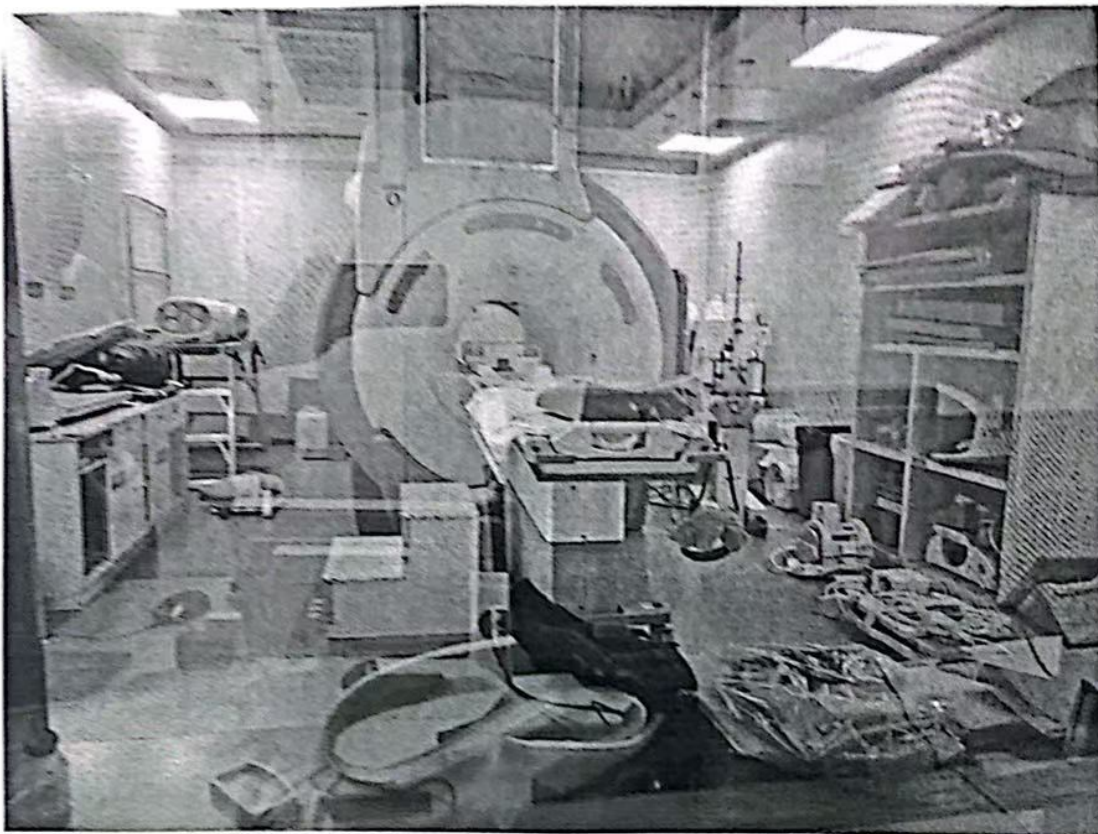

已校准 X0722864

器具编号: 2772WH2

建议下次校准日期 2025 年 09 月 25 日

重庆市计量质量检测研究院

固 定 资 产 标 识 卡	
资产编码	372019850
资产名称	核磁共振
使用科室	渝中放射科检查室
规格型号	1.5T Signa HDxt
出厂编码	
验收日期	2014-02-20

